iHealth Bluetooth - glucomètre voir page 2

GLUCOMÈTRES POUR CONTRÔLE QUOTIDIEN DU DIABÈTE

Glucomètres de pointe.
Disponibles seuls ou en kit complet. Le kit comprend: 10 bandelettes, puce d'étalonnage, solution témoin, 10 lancettes stériles, stylo piqueur, embout transparent (pour avant-bras ou paume), sac de transport, mode d'emploi, journal.
Caractéristiques principales:
- résultat précis en 10 s seulement
- échantillon de 1 µl seulement
- étalonnage automatique à puce
- résultats d'étalonnage du plasma
- gestion avancée des données avec moyenne sur 7, 14 et 30 jours
- économique pour des analyses fréquentes
- souple pour piqûre sur l'avant-bras, la paume ou le doigt

CE 0123 FDA

- TECHNOLOGIE BIOCAPTEUR
- DURÉE DE L'ANALYSE 10 S
- ÉCHANTILLON DE SANG DE 1 µL

Application facile grâce à l'effet capillaire

Étalonnage simple grâce à la puce Résultats d'étalonnage du PLASMA

23891

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Plage de mesure	20 - 600 mg/dL ou 1,1 - 33,3 mmol/L
Sites de piqûre - taille	Doigt, avant-bras ou paume - 1 µl
Durée analyse	Environ 10 secondes
Alimentation	Une pile bouton de 3,0 V 2032 ou équivalente
Durée de la pile	12 mois ou environ 1 000 analyses
Mémoire Plus	Jusqu'à 300 enregistrements avec date et heure

mg/dL			mmol/L	GLUCOMÈTRE ON CALL® PLUS
Italien Grec	Anglais Français	Espagnol Portugais	Anglais Français	
23890	**23891**	**23892**	**23881**	Glucomètre Plus - seul
23895	**23896**	**23897**	**23886**	Glucomètre Plus - kit

Code GIMA	Accessoires et consommables pour GLUCOMÈTRE
23910	Bandelettes glucose - boîte de 25
23912	Bandelettes glucose - boîte de 50
23913	Bandelettes glucose - boîte de 100
23914	Solution témoin
23915	Stylo autopiqueur «On Call»
23919	Stylo autopiqueur méthode AST
23917	Lancettes 28G pour 23915 - stériles - boîte de 25
23916	Lancettes 28G pour 23915 - boîte de 100

23896

LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ

24515

LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ SURGILANCE™
Système multi-usage de prélèvement de sang capillaire pour toutes les analyses. La lancette de sécurité One-Step est d'un usage plus facile, moins douloureux et plus sûr: une fois utilisée, la lancette est rendue inopérante. Méthode de propulsion et pénétration rapides minimisant la douleur du patient et le risque d'erreur de l'opérateur. Sans latex, hypoallergénique, jetable, sterile.

LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ SURGILANCE™								
Code GIMA	Coloris	Profondeur de pénétration	Calibre	Volume de sang	Piqure du doigt	Glucose	Hématocrite	Commande minimum
24513	Jaune	1,0 mm	G26	5-10 µl	•	•		boîte de 100
24514	Gris	1,8 mm	G23	10-20 µl	•	•		boîte de 100
24515	Orange	2,2 mm	G22	20-40 µl	•	•	•	boîte de 100

LANCETTES ET STYLOS PIQUEURS

• 23915 STYLO AUTOPIQUEUR «ON CALL»
• 23919 STYLO AUTOPIQUEUR - méthode AST
Stylos autopiqueurs en plastique, réutilisables. Pointe réglable pour un ajustement précis de la pénétration de la lancette. La méthode AST permet de contrôler la glycémie depuis le doigt, la paume, l'avant-bras et la partie supérieure du bras.

23915

23919

• 23917 LANCETTES GIMA - 28G - boîte de 25
• 23916 LANCETTES GIMA - 28G - stérile - boîte de 100
Les lancettes peuvent être utilisées avec les codes 23915, 23919 et la plupart des stylos piqueurs sur le marché.
Boîte multingue: (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, AR).

23916

TAMPONS À L'ALCOOL

• 36598 TAMPONS ALCOMED - boîte de 100
• 36599 TAMPONS ALCOMED - carton de 10000 (100 boîtes de 100)
Tampons imprégnés d'alcool isopropylique 70%, pour désinfecter la peau avant les piqures.
Dimensions: pochette 50 x 50 mm, tampon plié 32,5 x 30 mm, tampon ouvert 65 x 30 mm.

36598

AIGUILLES POUR STYLO À INSULINE, VOIR P. 40

MULTICARE «IN» - AUTOTEST DES FACTEURS DE RISQUE

- **23965 KIT MULTICARE «IN» - manuel en italien**
- **23966 KIT MULTICARE «IN» - manuel en anglais**
- **23967 KIT MULTICARE «IN» - manuel sur CD multilingue***

Comprend 10 langues: GB, IT, FR, ES, GR, PT, PL, SL, HU, TR

Nouvelle approche pour l'autotest périodique des facteurs de risque - cholestérol, triglycérides et glucose. Le seul appareil à biocapteur absorbant réflectométrique et électrochimique. Multicare «IN» est fourni dans une boîte en carton avec 1 sac en nylon, 10 bandelettes glucose, 1 stylo piqueur, 10 lancettes, 1 guide rapide et 1 manuel.
Boîte en 7 langues (IT, GB, FR, ES, GR, PT, PL).

Le premier et unique appareil multiparamétrique à double technologie

BANDELETTE ABSORBANTE BIOCAPTEUR - glucose

- Technologie électrochimique pour plus de facilité.
- Ne requiert que des échantillons sanguins de faible volume (1 µl).
- Obtention rapide des résultats (5 s).

BANDELETTE ABSORBANTE RÉFLECTOMÉTRIQUE - cholestérol et triglycérides

- multiCare in possède une technologie unique.
- Il permet un autotest plus fonctionnel des triglycérides et du cholestérol.

Code GIMA	BANDELETTES DE RECHANGE POUR MULTICARE «IN» boîte en 7 langues
23969	Bandelettes glucose Biocapteur - tube de 25 bandelettes + 1 puce
23970	Bandelettes glucose Biocapteur - tube de 50 bandelettes + 1 puce
23971	Bandelettes cholestérol - tube de 5 bandelettes + 1 puce
23972	Bandelettes cholestérol - tube de 25 bandelettes + 1 puce
23973	Bandelettes triglycérides - tube de 5 bandelettes + 1 puce
23974	Bandelettes triglycérides - tube de 25 bandelettes + 1 puce
	SOLUTIONS TÉMOINS POUR MULTICARE «IN»
23978	Solution témoin glucose
23979	Solution témoin cholestérol
23980	Solution témoin triglycerides
	LANCETTES POUR MULTICARE ET MULTICARE «IN»
23940	Lancettes 28G - sachet de 25 unités - stériles
23916	Lancettes 28G - boîte de 100 unités - stériles

- **23982 LOGICIEL POUR MULTICARE «IN» - GB, FR, IT, ES**

Système d'exploitation nécessaire pour l'installation: Windows XP, Vista, 16 Mb Ram, 10 Mb d'espace résiduel sur disque dur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Plage de mesure	Temps de mesure	Échant.
Glucose électrochimique	10-600 mg/dL	5"	1 µl
Cholestérol	130-400 mg/dL	30"	10 µl
Triglycérides	50-500 mg/dL	30"	10 µl
Mémoire:	500 résultats avec date et heure		
Batterie:	2 piles lithium Cr 2032 3 V (32212)		
Dimensions:	97 x 49 x 20,5 mm		
Poids:	65 g		

LECTEURS DE POCHE POUR LE CHOLESTÉROL, LES TRIGLYCÉRIDES ET LE GLUCOSE

- **23948 KIT MULTICARE - manuel GB/ES**
- **23950 KIT MULTICARE + 10 bandelettes glucose - manuel GB/IT**

Appareil de diagnostic unique pour autotest de glucose, cholestérol et triglycérides.

La technologie multiparamètre mesure différents paramètres avec le même réflectomètre, en changeant simplement le type de bandelette: chaque boîte contient une puce spécifique à l'analyse. Le contrôle régulier de ces 3 paramètres est important pour **prévenir les pathologies cardiovasculaires**: en effet l'intolérance au glucose, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie sont 3 des principaux facteurs de risque cardiovasculaire, avec l'âge, l'obésité, le mode de vie, le tabac et l'hypertension artérielle. Multicare est fourni dans une boîte en carton en 3 langues (GB, IT, ES) avec 1 sac en nylon, 1 stylo piqueur, 10 lancettes, 1 manuel (GB, IT, ES). Manuel en FR ou PT disponible sur demande.

- **32212 BATTERIE LITHIUM CR2032**

Code GIMA	BANDELETTES ET SOLUTIONS TÉMOINS POUR MULTICARE
23955	Bandelettes glucose - tube de 25 bandelettes + 1 puce
23956	Bandelettes glucose - tube de 50 bandelettes + 1 puce
23957	Bandelettes cholestérol - tube de 5 bandelettes + 1 puce
23958	Bandelettes cholestérol - tube de 25 bandelettes + 1 puce
23959	Bandelettes triglycérides - tube de 5 bandelettes + 1 puce
23960	Bandelettes triglycérides - tube de 25 bandelettes + 1 puce
23961	Solution témoin glucose
23962	Solution témoin cholestérol
23963	Solution témoin triglycérides

Écran large LCD pour une lecture aisée
APPAREIL POUR AUTOTEST
100 % technologie italienne
CE 0344
23950
Multifonction
Chaque boîte de bandelettes a sa propre puce codée pour une mesure sûre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure glucose: 25-500 mg/dL (1,3-28 mmol/L)
triglycerides 50-500 mg/dL (0,5-5,6 mmol/L)
cholestérol 130-400 mg/dL (3,3-10,2 mmol/L)
Mémoire: 255 résultats avec date et heure
Dimensions: 48 x 104 x 20,5 mm Poids: 65 g Batterie : 2 piles

Pratique
Activation de l'appareil par insertion de la bandelette ou pression du bouton

Souple
La goutte de sang peut être appliquée sur la bandelette avant ou après son insertion

Innovant
Volume de sang réduit: 3 microlitres requis pour le test du glucose

TEST RAPIDE STREP-A, RÉSULTATS PRÉCIS EN 5 MINUTES

• 24522 STREP-A - lecteur - boîte de 20 tests
• 24523 STREP-A - bandelettes - boîte de 25 tests

Résultats précis en quelques minutes, procédure simple à réaliser et interpréter. Le diagnostic immédiat permet de décider le traitement du patient au cours de la même visite.
Conservation à température ambiante. Comprend 20 lecteurs ou 25 bandelettes (sachet individuel), 2 réactifs, 20 (ou 25) tubes et écouvillons. Mode d'emploi et emballage multilingues. Utilisation professionnelle.

Procédure:
- ajoutez 4 gouttes de réactif A, puis les gouttes de réactif B
- faites tourner l'écouvillon 10 fois, attendez 1 minute, puis ôtez-le en pressant le tube pour chasser le liquide
- placez la pointe du compte-gouttes au sommet du tube (24522)
- ajoutez 3 gouttes de l'échantillon (24522)
- plongez la bandelette dans l'échantillon (24523)
- lisez les résultats après 5 minutes

24523

Détail de la bandelette et du lecteur inclus dans 24523 et 24522

24522

• 24524 STREP-A - twister - boîte de 25 tests
Mêmes caractéristiques que l'article 24522 mais avec test de type cassette intégré et tube de prélèvement en un seul appareil. Permet une procédure de test simplifiée et rapide pour l'utilisateur.
Inclus 25 cassettes twister, 2 réactifs, 25 écouvillons. Mode d'emploi et emballage multilingues. Utilisation professionnelle.

24524

BANDELETTES URINAIRES OTC: ITU, GLU/CET ET 10 PARAMÈTRES

Bandelettes Glu/Cet
24065

Bandelettes infection urinaire
24066

Bandelettes 10 paramètres
24070

Avantages de l'analyse d'urine OTC
- pratique: réalisez une analyse sans sortir de chez vous: facile à réaliser et à lire
- précis: résultats fiables avec les mêmes bandelettes que votre médecin
- économique: ni analyseur de laboratoire, ni lecteur
- rapide: résultat en 2 minutes
- durée de vie supérieure. Le conditionnement en étui fermé garantit une conservation de 18 mois, contre 3 mois pour des bandelettes en boîte ouverte.

CE 0197

• 24065 BANDELETTES GLU/CET - 3 étuis de 3 bandelettes - autotest
Glucose: surveillance de l'excès de glucose des patients diabétiques avec contrôle de l'état de santé général
Cétones: contrôle des patients diabétiques par dépistage d'un excès de cétones dû à une faible insulinémie. Surveillance du niveau de cétones lors de régimes pauvres en calories ou en hydrates de carbone

• 24066 BANDELETTES ITU (INFECTION TRAIT URINAIRE) - 3 étuis de 3 bandelettes - autotest
- contrôle du nitrite et des leucocytes en une analyse pour le dépistage des ITU
- détecte les ITU avant l'apparition des symptômes

• 24070 BANDELETTES 10 PARAMÈTRES - 3 étuis de 3 bandelettes - autotest
Bandelettes compatibles avec le lecteur Bayer CLINITEK-100
- contrôle de l'état de santé général
- une seule bandelette vérifie le niveau des leucocytes, nitrite, urobilinogène, protéines, pH, sang, gravité spécifique, cétones, bilirubine, glucose
- contrôle de: alimentation, infections urinaires, tumeurs, troubles rénaux, goutte, fièvre, cirrhose, hépatite virale, troubles hépatiques, insuffisance cardiaque congestive, jaunisse, diabète et insuffisance rénale aiguë.

24070

AVERTISSEMENT: PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Lors de leur fabrication, la date d'expiration est fixée à 24 mois. La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à 22 mois.

ANALYSEUR D'URINE ANALYTICON ET BANDELETTES URINAIRES

Urilyzer 100
START
Interface intuitive, écran tactile
24051
Prise de mesure facile, propre et sûre par détection de la bandelette
TECHNOLOGIE ET PRÉCISION ALLEMANDES

MADE IN GERMANY
combi screen 10SL PLUS
CombiScreen® 10SL
100
analyticon
Bandelettes urinaires pour glucose et sang avec tampon protégé par acide ascorbique
Bandelettes dans un tube en métal conditionné dans une boîte unique en carton
24061
analyticon

• 24051 ANALYSEUR URILYZER® 100 - avec imprimante
• 33250 PAPIER IMPRIMANTE 57 x Ø 50 mm - boîte de 50 rouleaux

Urilyzer 100 est un petit lecteur de bandelettes urinaires aux nombreuses caractéristiques. L'interface intuitive facilite la saisie de données et permet d'insérer manuellement la couleur et la turbidité à partir d'une liste prédéfinie ou avec une observation supplémentaire.
L'utilisateur dispose d'un niveau élevé de personnalisation, de tests et d'options de rapports.
La base de données intelligente est dotée de filtres multiples.
À utiliser avec les bandelettes urinaires 24062 et 24063 uniquement.
Mode d'emploi sur CD en GB, DE, IT, SE, NO et DK.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesures:	50 mesures/h en mode classique, 120 mesures/h en mode rapide
Mémoire:	1000 résultats tests patient et 500 résultats essais CQ
Écran:	tactile LCD, 3,5'', QVGA
Imprimante:	imprimante thermique silencieuse avec rouleau de papier pour env. 280 mesures.
Impression:	mesure en cours, date et heure, no de série du lecteur, ID du patient, * signalant les résultats pathologiques, les paramètres peuvent être imprimés en unités SI, conventionnelles et arbitraires.
Précision:	5 niveaux de réglage du lecteur selon les exigences
Type:	long. d'ondes de réflectance du photomètre 505, 530, 620, 660 nm
Interfaces:	port série RS232, USB A, USB B, PS2 (clavier externe, lecteur code-barres) carte microSD
Dimensions/Poids:	190 x 260 x 77 mm (L x L x H) / 1,5 kg
Alimentation:	100-240 V, 50-60 Hz
Fabriqué en Hongrie	

ANALYTICON COMBI SCREEN® PLUS et SYS - BANDELETTES URINAIRES
Bandelettes urinaires pour tests visuels ou à utiliser avec Urilyzer® 100 et CombiScan 100 (24062 et 24063 uniquement).
• 24060 COMBI SCREEN® PLUS - 3 paramètres - tube de 100 band.
• 24061 COMBI SCREEN® PLUS - 10 paramètres - tube de 100 band.
• 24063 COMBI SCREEN® PLUS - 11 paramètres - tube de 100 band.

Résultats lisibles directement sur la bandelette (après 60 s environ) à comparer à l'étiquette du tube. Protection contre l'acide ascorbique dans le glucose et dans le sang. Diminution des résultats faussement négatifs dus aux interférences avec l'acide ascorbique. Utilisation professionnelle.
Mode d'emploi en GB, FR, GR, IT, ES, PT, NL et DE disponibles sur demande.
Production allemande.

GIMA code	24060	24061	24063	24062
Leucocytes		•	•	•
Nitrite		•	•	•
Urobilinogène		•	•	•
Protéines (albumine)	•	•	•	•
pH	•	•	•	•
Sang		•*	•*	•**
Gravité spécifique		•	•	•
Cétones (ac. Acétylacétique)		•	•	•
Bilirubine		•	•	•
Glucose	•*	•*	•*	•**
Ac. ascorbique			•	•

*Protection contre l'ac. ascorbique **Sans protection contre l'ac. ascorbique

• 24062 COMBI SCREEN® SYS - 11 paramètres - tube de 150 band.
Caractéristiques identiques à l'article 24063 mais sans tampon de protection acide ascorbique sur le glucose et le sang.

BANDELETTES URINAIRES GIMA

• 24069 BANDELETTES 10 PARAMÈTRES - tube de 100
• 24071 BANDELETTES 11 PARAMÈTRES - boîte avec 5 étuis de 3
• 24072 BANDELETTES 11 PARAMÈTRES - tube de 50

Bandelettes compatibles aussi avec le lecteur CLINITEK-100 Bayer - contrôle des conditions générales de santé - mesure du niveau de leucocytes, nitrites, urobilinogène, protéines, pH, sang, gravité spécifique, cétones, bilirubine, glucose, acide ascorbique (24071 et 24072 uniquement) avec une bandelette - contrôle de la nutrition, infections de l'appareil urinaire, tumeurs, problèmes rénaux, goute, fièvre, cirrhose, hépatite virale, maladies du foie, insuffisance cardiaque, jaunisse, diabète et insuffisance rénale aiguë.
Utilisation professionnelle uniquement.

GIMA

ATTENTION: PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Les tests ont une durée de 24 mois après la production. Notre stock peut varier de 10 à 22 mois.

MARQUEUR CARDIAQUE

• 24525 MARQUEUR CARDIAQUE - 3 paramètres: CK-MB, Troponine, Myoglobine - boîte de 20 tests
Vérifie l'état cardiaque et les AVC en 15 min seulement. Idéal pour surveiller les patients atteints de cardiopathies ou après la chirurgie ou une crise cardiaque. L'infarctus aigu du myocarde - IAM (crise cardiaque) provoque un décès sur cinq aux É-U. 6 heures après apparition d'un IAM, les dégâts du muscle cardiaque sont permanents et irréversibles. Un diagnostic IAM rapide et précis est donc essentiel. La méthode ECG est la plus souvent utilisée dans les diagnostics des IAM. Malheureusement, 25% des gens présentant un IAM ont un ECG normal. La gamme de tests GIMA relève les marqueurs (biochimique ou protéine) d'un IAM tels que la créatine kinase MB (CK-MB), la myoglobine (MB) et la troponine I cardiaque (TnIc), en même temps. L'efficacité de ce test est reconnue dans le monde entier.
Inclus: 20 compte-gouttes, 20 plaquettes de test et 1 bouteille avec 1 solution de dilution. Utilisation professionnelle.

TEST D-DIMÈRE

• 24526 TEST D-DIMÈRE- boîte de 20 tests
La présence de D-Dimère dans les échantillons sanguins indique différents troubles de la coagulation, incluant la thrombose veineuse profonde (TVP), l'embolie pulmonaire (EP) et l'athérosclérose. Le test D-Dimère, très utilisé, est une méthode simple pour la détection de TVP ou EP. Il facilite la prévention: un résultat négatif indique un bon état de santé et une haute concentration révèle une augmentation de l'activité du fibrinogène et de la coagulation sanguine. La sensibilité du test D-Dimère Ameritek est de 97% (174/178) et la spécificité est 92% (114/122) conformément aux normes de Dade Behring Stratus CS - DDMR Immunoassay System.
Inclus: 20 compte-gouttes, 20 plaquettes de test et 1 bouteille avec solution de diluition.
Utilisation professionnelle.

TEST MALARIA

• 24547 TEST MALARIA - boîte de 40 tests
Le dispositif de test rapide Malaria P.f. (sang complet) est un dosage immunologique par chromatographie rapide pour la détection qualitative de Plasmodium falciparum circulant dans le sang complet. La comparaison avec les analyses microscopiques par frottis sanguins épais ou fin classique révèle une corrélation de plus de 99,0 %.
La boîte comprend les dispositifs de test, le tampon, le compte-gouttes jetable et le mode d'emploi
Utilisation professionnelle.

24547

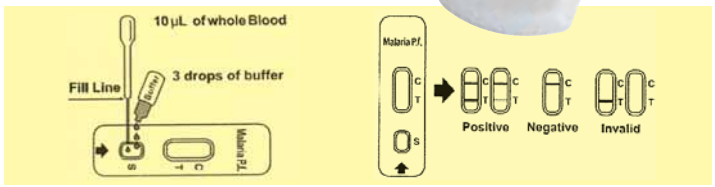

TEST CRP SEMI QUANTITATIF

• 24527 TEST CRP - boîte de 20 tests
La mesure de la CRP dans le sang complet, plasma ou sérum a deux utilités:
1) le taux de hs-CRP aide à évaluer le risque de maladie vasculaire périphérique et cardiovasculaire. Plus la valeur hs-CRP est haute, plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé.
2) le niveau de CRP aide à identifier et garder une trace des infections ou maladies causant des inflammations (lymphome, lupus, artérite à cellules géantes, ostéomyélite, polyarthrite rhumatöide...)
- ponction digitale sur sang complet ou sérum/plasma
- résultats en 7 minutes
- bandes colorées très voyantes
- contrôle des performances et bande de référence integrés
- conservation à température ambiante
- contient 20 tests avec compte-gouttes

Utilisation professionnelle.

24527

TEST DÉPISTAGE PRÉCOCE SANG FÉCAL OCCULTE FOB

• 24530 TEST FOB - boîte de 25 tests
Résultats précis en quelques minutes.
Pour une décision de traitement précoce.
Procédure simple, facile à réaliser et interpréter. Aucun matériel supplémentaire requis. Comprend 25 écouvillons, le dispositif de test et le flacon de solution tampon.
Utilisation professionnelle.

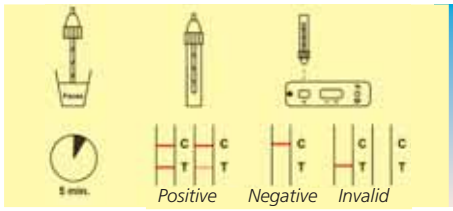

24530

TEST GRIPPE A/B

• 24537 TEST GRIPPE A/B - boîte de 30 tests (3 paquets de 10 unités)
Test rapide in vitro pour détecter les antigènes de type A et B de la grippe (nucléoprotéine) extraits des échantillons nasaux. Conçu pour détecter les nucléoprotéines des sous-types du noyau flu-A, indépendant des protéines de surface H et N (compris (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, H9N2). Tampon nasal stérile pour le prélèvement facile de l'échantillon. Résultat en 10-15 min. Comprend tableau de contrôle, tube de test, tampon de prélèvement.
Utilisation professionnelle uniquement.

24537

TEST MONONUCLÉOSE

• 24538 TEST MONONUCLÉOSE - boîte de 20 tests
Test rapide pour le diagnostic de la Mononucléose Infectieuse (MI): détecte qualitativement les anticorps hétérophiles de MI dans le sang complet, le sérum ou le plasma.
Pour diagnostic professionnel in vitro uniquement.
Résultats en 5 min.
Inclus 20 tests de type cassette, 20 compte-gouttes, tampons et mode d'emploi.

24538

AVERTISSEMENT: PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Lors de leur fabrication, la date d'expiration est fixée à 2 ans.
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à 22 mois.

TEST URINAIRE DE DÉPISTAGE DE MICROALBUMINE - MALADIE RÉNALE

• 24539 TEST URINAIRE DE DÉPISTAGE DE MICROALBUMINE - boîte de 1 test
Test visuel facile à utiliser pour détecter un niveau élevé d'albumine dans l'urine, un signe d'alerte pour les maladies rénales. Une détection rapide est nécessaire: les deux principales causes de maladies rénales sont le **diabète et l'hypertension.**
- excellente corrélation avec les tests cliniques
- test urinaire simple et facile à utiliser, résultats en 10 minutes
- détecte 18 mg/L d'albumine dans l'urine (comme les tests professionnels)
- contient tout le nécessaire pour que l'utilisateur effectue le test
- marquage CE pour appareil d'autotest

CE 0459

L'Association Américaine pour les Diabétiques et la Fondation Américaine pour les Reins recommandent un test par an.

TEST CANCER DU CÔLON, POUR AUTOTEST À DOMICILE

AUTOTEST

• 24531 AUTOTEST CANCER DU CÔLON
Facile à réaliser à domicile pour la détection précoce des troubles colorectaux, avant l'apparition des symptômes. Contient 5 tampons de test, 1 pochette de contrôle positif, les cartes de résultat et 1 mode d'emploi.
- facile à placer dans la cuvette des toilettes pour détecter le sang occulte dans les selles
- aucune procédure de laboratoire, résultats en 2 minutes

L'Association Américaine pour le Cancer recommande un dépistage annuel après 50 ans. Avec une détection précoce et un traitement colorectal, le cancer peut être soigné.

CE 0197

24531

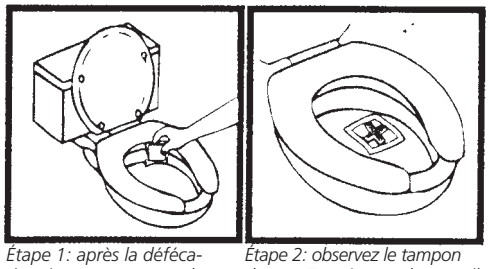

Étape 1: après la défécation, jetez un tampon de test dans la cuvette.

Étape 2: observez le tampon de test. En présence de sang, il vire au bleu dans les 2 minutes.

HELICOBACTER PYLORI DIAGNOSTIC RAPIDE DES ULCÈRES

PROFESSIONNEL

• 24528 TEST HELICOBACTER PYLORI - boîte de 40 tests
Helicobacter pylori est la principale cause d'ulcères gastriques: ce test simple permet un diagnostic rapide en 10 minutes env. Facile à réaliser et interpréter, aucun matériel supplémentaire requis. Pour utilisation professionnelle.
Diagnostic des infections H.pylori pour adultes de plus de 18 ans.

CE 0197

• 24529 AUTOTEST HELICOBACTER PYLORI - boîte de 1 test
Mêmes caractéristiques que l'article 24528 mais conditionné dans une boîte individuelle avec lancette automatique, tampon unique et mode d'emploi. Ce produit bénéficie d'une certification autotest autorisant sa vente à l'utilisateur final sur le marché OTC.

24529

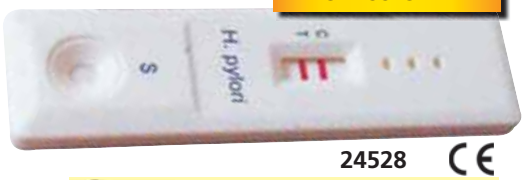

24528 CE

AUTOTEST

PSA - TEST DÉPISTAGE PROSTATE ONE-STEP

• 24534 TEST PSA - boîte de 25 tests - pour cabinet/hôpital
Résultats précis en 5-8 minutes.
- corrélation avec les tests de laboratoire >98%
- test sur sérum ou plasma d'usage facile
- détection du PSA à partir de 4 ng/ml
- matériel complet nécessaire au test fourni, sauf lancette voir p. 5
- pour utilisation professionnelle

CE

• 24532 AUTOTEST PSA - boîte de 1 test - pour autotest
Mêmes caractéristiques que l'article 24534, mais en boîte individuelle avec 1 lancette automatique, 1 tampon et 1 mode d'emploi. Bénéficie d'une certification autotest autorisant sa vente à l'utilisateur final.

24532

AUTOTEST

CE 0197

24532

TEST CHOLESTÉROL

AUTOTEST

• 24521 BANDELETTES CHOLESTÉROL - boîte de 2 unités
Série de bandelettes, économique et certifiée CE, pour la lecture visuelle du cholestérol du sang complet.
Aucun lecteur requis. L'échelle des couleurs permet une lecture par comparaison plus aisée pour une meilleure interprétation des résultats.
Tube de 2 tests cholestérol accompagné de stylos piqueurs, d'une échelle des couleurs et du mode d'emploi.
Boîte et mode d'emploi en GB, DE, IT.

CE 0197

24521

TEST DE DÉPISTAGE DES ALLERGIES

• 24580 TEST D'ALLERGIE AUX CHATS - boîte de 1 test - CE 0197
• 24581 TEST D'ALLERGIE AUX CHIENS - boîte de 1 test - CE 0459
Simple, fiable et cliniquement prouvé:
- résultat en 15 minutes
- excellente corrélation avec les tests de laboratoire
- facile d'utilisation par ponction digitale
- pour autotest
- dispositif de test, ampoule de solution d'essai, dispositif de ponction digital, mode d'emploi inclus dans chaque test.

AUTOTEST

CE 0197

24580

AVERTISSEMENT: PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Lors de leur fabrication, la date d'expiration est fixée à 2 ans.
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à 22 mois.

ÉTHYLOTEST

• 24500 ÉTHYLOTEST
Appareil compact pour mesurer la concentration d'alcool dans votre haleine. Interface et animation numériques/ graphiques, manipulation d'une main. Valeurs ‰ BAC et mg/l. Fourni dans une boîte en carton avec 3 embouts de soufflage Ø 7 mm et un bouchon de nettoyage.
• 24501 EMBOUTS DE SOUFFLAGE - boîte de 12
• 32200 PILES «AAA» - paquet de 4
• 24503 PRÉSENTOIR COMPTEUR - italien
• 24504 PRÉSENTOIR COMPTEUR - anglais

Écran large pour lire la valeur exacte dans votre haleine (rétro-éclairage 3 couleurs)

24500

Le présentoir contient 6 unités.

24503

AUTOCONTRÔLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage: basse et 0,15 ~ 1,50 ‰ BAC ou 0,075 ~ 0,75 mg/l
Précision: ± 0,2 ‰ BAC plage complète sous niveau d'alerte
Alimentation: 3 piles 1,5 V AAA (non incluses)
Écran: affichage graphique et numérique à 3 décimales (ex. 0,025 % BAC)
Compensation de tolérance: fonction de préalerte et rétroéclairage tricolore
Échantillonnage haleine: respiration continue <5 secondes
Durée entre 2 cycles: environ 20 secondes
Dimensions unité: 107 x 45 x 25 mm approx.
Poids: 50 g (sans piles)
Calibrage de l'alarme de niveau:0,5 ‰ BAC ou 0,25 mg/l

ÉTHYLOTEST PROFESSIONNEL

• 24491 ÉTHYLOTEST FIT-133 avec imprimante
• 24494 EMBOUTS DE SOUFFLAGE - boîte de 100 unités
• 24495 ROULEAUX DE PAPIER pour 24491 - boîte de 10
Éthylotest à capteur à **pile à combustible** professionnel avec imprimante et écran tactile. La pile à combustible est un disque poreux avec une fine couche de platine noir; l'alcool entrant en contact avec la surface de la cellule est décomposé chimiquement. Chaque molécule d'alcool décomposée libère un nombre donné d'électrons en proportion de la quantité d'alcool.

Éthylotest[1] fourni avec imprimante intégrée, 25 embouts buccaux[2], 1 grand embout buccal[3], alimentation[4], alimentation 100-240 V, 50/60 Hz[5], adaptateur USB pour voiture[7], module de transmission sans fil pour imprimante FIT-133[6,9], étui de transport[10], 4 rouleaux de papier[11], chargeur[12]

Dimensions: 188 x 78 x 33 mm
Poids: 300 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Écran: Couleur LCD 3.2 TFT tactile et affichage de formes d'onde
Clavier: 5 touches de fonction: «up», «down», «left», «right», «ok»
Alimentation: Batterie rechargeable AA (env. 2500 mAh)
Préchauffage: La chambre et le capteur sont préchauffés
Détection automatique: Flux détecté automatiquement
Température de stockage: -40°C à +85°C
Température de fonctionnement: -20°C à +70° (optimum de -20° à +40°)
Téléchargement des données vers PC: Transfert vers PC par câble USB (fichier CSV)
Compatibilité: Windows XP, 7
Mémoire: min. 10 000-18 000 sauvegardes (env 3 000 tests) avec toutes les info (noms du lecteur de l'examinateur, n° du véhicule, résultat du test avec timbre à date et heure, emplacement, données de calibration…)
Précision des mesures: Écart type ±0,025 mg/L ou ±5% des mesures
Dérive: en général <0,8% de la valeur de mesure/mois

ÉTHYLOTEST DE POCHE

• 24499 ÉTHYLOTEST DE POCHE
Éthylotest de poche simple d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage: basse et 0,2 ~ 1,5 % BAC
Précision: ±0,2 ‰ BAC au point d'étalonnage (niveau d'alerte)
Alimentation: 2 piles 1,5 V AAA (non incluses)
Écran: affichage numérique
Compensation de tolérance: fonction de préalerte à l'approche de la limite
Extinction automatique: 2 minutes
Échantillonnage de l'haleine par auto détection du flux: env. 6 s en respiration continue
Temps du cycle: environ 20 s
Étalonnage niveau d'alerte: 0,5 % BAC

DE POCHE, SEULEMENT 8,5 x 3 x 1 cm

BANDELETTES ALCOOL DANS LA SALIVE

• 24502 BANDELETTES DE TEST D'ALCOOL DANS LA SALIVE - boîte de 25 bandelettes
Test salivaire rapide de grande sensibilité pour déterminer la concentration relative d'alcool dans le sang.
- résultats en 2 minutes seulement
- l'échelle des couleurs fournit les concentrations d'alcool dans le sang (BAC) approx. de 0,02% à 0,30%
- aucune instrumentation requise
- le test salivaire évite le prélèvement d'urine
- expiration rapide (8-10 mois) environ
- utilisation professionnelle

1. Saturez le tampon de réaction

24502

2. Lisez les résultats après 2 minutes

TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUES À DOMICILE

• 24564 DRUG KOP - boîte de 1 test
• 24565 DRUG KOP - boîte de 10 tests

AUTOCONTRÔLE

24564

Nouveau test colorimétrique pour le dépistage rapide et précis des principales substances contenues dans les drogues illicites et certains médicaments. Ce test mesure et détecte les 21 drogues toxicomanogènes (DOA) suivantes dans une concentration de 5 mg: amphétamines, benzphétamines, cocaïne, codéine, dextrométhorphan, diphenhydramine, doxylamine, héroïne, hydrocodone, kétamine, LSD (contenant une amine secondaire), méphentermine, méthadone, méthamphétamine, morphine, opium, phéncyclidine (PCP), prométhazine, thébaïne, tryptamine, tyramine. Non adapté au cannabis.
Peut être réalisé avec les boissons ou sur les surfaces. Aucun réactif requis, résultats immédiats.
Très stable de -15 °C à 50 °C.

SYSTÈME DE DÉPISTAGE DRUG READER - POUR URINES, SUR PLAQUETTE OU EN BOCAL

• 24570 DRUG READER - logiciel en italien
• 24571 DRUG READER - logiciel en anglais
• 24574 PLAQUETTE MULTIDROGUEs - 8 drogues
• 24576 BOCAL MULTIDROGUES - 7 drogues + S.V.T.
• 24577 BOCAL MULTIDROGUES - 8 drogues + S.V.T.
• 24578 BOCAL MULTIDROGUES - 8 drogues + S.V.T.
Récupérez une analyse complète sur votre PC, en numérisant l'1 des 3 tests multidrogues sur le Drug Reader.
- analyse des tests en plaquette «à lecture visuelle»
- reconnaissance automatique du menu de test (code-barres 2D)
- processus de vérification du contrôle de qualité
- capture d'images, gestion/exportation des données, résultats archivés
- convient pour l'utilisation de multiples formats/menus de test

Principaux avantages:
- automatisation: élimine la variabilité/subjectivité de l'interprétation des résultats
- précision: meilleure performance par rapport à l'interprétation visuelle
- rapidité: la numérisation nécessite 15-30 sec.
- flexibilité: léger, semi portable, installation aisée

DROGUE	24574	24576	24577	24578	SEUIL NG/ML	Temps de détection
MTD	•	•	•	•	300	5-7 jours
MDMA	•	•	•	•	500	5-7 jours
MET	•	•	•	•	500	3-5 jours
COC	•	•	•	•	300	2-5 jours
THC	•	•	•	•	50	-
AMP	•	•	•	•	500	2-5 jours
MOP	•	•	•	•	300	5-7 jours
BUP	•		•		10	5-7 jours
BUP				•	5	5-7 jours
S.V.T.						
OX		•	•			
S.G.		•	•			
PH		•	•			
NiT		•	•			
Glut		•	•			
CRE		•	•			

24576 24574 24577

Adapté pour le contrôle des travailleurs en médecine du travail. Formats/menus de test multiples, compatible Windows

24576 24577 24574 24570

TEST «FLACON» MULTIDROGUES

• 24546 TEST «FLACON» MULTIDROGUES - urine boîte de 25 tests pour 7 drogues
Détecte les paramètres suivants: (MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.
Utilisation professionnelle.
- emploi facile: pas de manipulation d'urine, il suffit d'insérer la clé dans le test actif et lire les résultats après 5 min.
- flacon à urines fermé hermétiquement: pas de fuites ou d'éclaboussures
- conception unique: l'urine utilisée pour le test reste séparée de celle résiduelle, non contaminée qui pourra être utilisée lors d'un test ultérieur
- clé conditionnée séparément: assure que seul le technicien peut commencer le test

Panneau de test solidement fixé au flacon pour éviter toute contamination

Étiquette de température

FLACON DE TEST DE DÉPISTAGE - 24546		
DROGUE	SEUIL NG/ML	TEMPS DE DÉTECTION*
MOP	300	5-7 jours
COC	300	2-5 jours
THC	50	-
AMP	500	2-5 jours
MDMA	500	5-7 jours
MTD	300	5-7 jours
MET	500	3-5 jours

**L'usage de drogues antérieur au temps de détection n'est pas mesuré*

TEST DROGUE SALIVAIRE

24555

Prélèvement de la salive avec une éponge

• 24555 TEST SALIVAIRE MULTIDROGUES fluide oral (salive) - boîte de 25 tests pour 6 drogues
Résultats précis en 10 min. pour les drogues suivantes: amphétamines, cocaïne, marijuana cannabis, méthamphétamines, opiacés, phencyclidine.
Seuils de détection conformes aux standards SAM HSA.
Pour hôpitaux et professionnels. Mode d'emploi multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.

DISPOSITIF DE TEST DE DÉPISTAGE SUR FLUIDE ORAL - 24555		
DROGUE	SEUIL NG/ML	TEMPS DE DÉTECTION
COC	20	10 min - 24 h
THC	30	jusqu'à 14 h
AMP	50	10 min - 72 h
MET	50	10 min - 72 h
PCP	10	-
OPI	40	1 h - plus d'un jour
MTD	45	Jusqu'à 2 jours

DROGUES TOXICOMANOGÈNES, TESTS URINAIRES POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE CE

• 24540 TEST COCAÏNE - bandelettes - urine - seuil: 300 ng/ml
• 24541 TEST MARIJUANA - bandelettes - urine - seuil: 50 ng/ml
• 24542 TEST OPIACÉS - bandelettes - urine - seuil: 300 ng/ml
Les articles 24540-41-42 sont vendus en boîtes de 50 bandelettes conditionnées en sachets individuels.
• 24550 TESTS PROFIL MULTIDROGUE urine boîte de 25 tests pour 6 drogues
• 24551 TESTS PROFIL MULTIDROGUE urine boîte de 25 tests pour 12 drogues
Ces tests fournissent des résultats précis en 10 min. pour les drogues suivantes:
amphétamines*, cocaïne*, marijuana cannabis*, méthamphétamines*, opiacés*, phencyclidine*, barbituriques, benzodiazépines, ecstasy, morphine 300, méthadone, antidépresseurs tricycliques.
*l'article 24550 inclut des tests pour les drogues signalées par un astérisque.
Seuils de détection conformes aux standards SAM HSA. Produits fournis avec un mode d'emploi multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.

24540-41-42

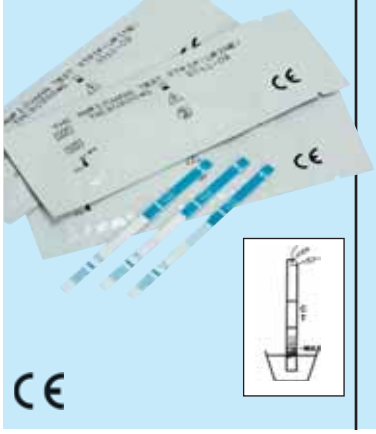

24550

24551

FLACON DE TEST DE DÉPISTAGE			
Drogue	Seuil ng/ml		Temps de détection
	24550	24551	
MOP	-	300	5-7 jours
COC	300	300	2-5 jours
THC	50	50	5-8 jours
AMP	1 000	1 000	2-5 jours
MDMA	-	500	5-7 jours
MTD	-	300	5-7 jours
MET	1 000	1 000	3-5 jours
BZO	-	300	7-10 jours
BAR	-	300	2 jours - 4 semaines
PCP	25	25	
OPI	2 000	2 000	5-7 jours
TCA	-	1 000	-

MICROSCOPES BIOLOGIQUES - GROSSISSEMENT DE 40X À 1 600X

• 31001 MICROSCOPE BIOLOGIQUE - GROSSISSEMENT 40X à 1600X
Microscope haute gamme à résolution et transmission élevées.
Caractéristiques principales:
- tête binoculaire sans compensation
- oculaire WF 10X, P16X
- objectifs achromatiques demi-plan 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, huile)
- quatre objectifs
- étape mécanique de double couche 140 x 140 mm / plage de mouvement 75 x 50 mm
- alimentation: interchangeable 110-220 V, 50 Hz

• 31005 AMPOULE DE RECHANGE (pour 31000 et 31001)

Système précis de mise au point.

Simplification des tests comparatifs avec la pince à 2 lames de l'étape mécanique.

Grand champ de travail à 4 objectifs. Image nette grâce à des objectifs de haute qualité.

31001

CAMÉRA UNIVERSELLE POUR MICROSCOPES
voir code 72566 page 176

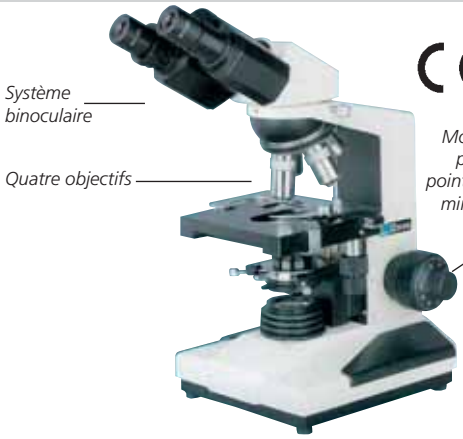

31000

• 31000 MICROSCOPE BIOLOGIQUE - 40X à 1 000X
- tête binoculaire sans compensation inclinée à 30°
- oculaire 10X (champ de 18 mm)
- objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, huile)
- grossissement total 40X, 100X, 400X, 1 000X, suivant l'objectif utilisé
- réglage de l'écartement des yeux: de 55 à 75 mm
- étape mécanique, double couche de 125 x 135 mm
- plage de mouvement: 75 x 35 mm
- condensateur Abbe avec diaphragme et filtre d'iris
- lampe halogène de 6 V, 20 W - réglage de luminosité
- alimentation: commutable 110-220 V, 50 Hz

• 31005 AMPOULE DE RECHANGE (pour 31000 et 31001)

CENTRIFUGEUSES POUR PLASMA, URINES ET FLUIDES BIOLOGIQUES

• 24031 CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE - pour 8 tubes avec rotor à angle fixe
• 24032 CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE - pour 6 tubes avec rotor à godets horizontaux
• 24040 TUBE D'ANALYSE boîte de 100 unités
Système de fermeture ZERO-RPM avec couvercle de blocage de sécurité, programmation numérique de la durée (intervalle compris entre 1 et 99 min.) et vitesse de 500-3300 rpm. Peut accueillir 6 ou 8 tubes d'analyse (3-15 ml) et atteint jusqu'à 1364 g avec rotor à angle fixe garantissant une séparation parfaite. Moteur à courant continu. Livrée avec une alimentation autocommutable de 110-220 V. Fabriquée aux É-U. Manuel en GB et IT.

24031-2

Dimensions: 27x37x37 cm

A *Couvercle*
B *Interrupteur marche/arrêt (prise d'alimentation c.a)*
C *Bouton run*
D *Bouton arrêt/ouverture*
E *Réglage de la vitesse*
F *Réglage de l'heure*
G *Orifice pour ouverture d'urgence*
H *fermeture du couvercle*

24031

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse nominale	500-3300 tpm (pas: 100 tpm)		
RFC normale	31-1364		
Volume maximum	120 ml		
Puissance maximum	12 W		Fusible: 7,2 A
Recommandations	**vitesse**	**durée**	
Sang complet	3300	10 min	
Urines	1800	5-10 min	

• 24035 CENTRIFUGEUSE XC-2000
Centrifugeuse plasma très silencieuse. Comprend 6 positions pour les tubes et un compteur électronique permettant le réglage précis de la vitesse, de 1 000 t/min à 4 000 t/min (paliers de 500 t/min). Fournie avec support en métal pour 6 tubes de 10 ml et un pour 6 tubes de 15 ml. Durée de fonctionnement réglable de 1 à 60 min. Structure robuste en ABS.
• 24040 TUBE D'ANALYSE 10 ml
boîte de 100 unités

24035

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220 V - 50 Hz
Puissance:	80 W
Vitesse:	Environ 1 000-4 000 t/min (par paliers de 500 t/min)
Temps:	1-60 min
Capacité:	15 ml ou 10 ml x 6
FCR max.:	1 790 g

LACTATE SCOUT+: MESURE DU LACTATE

• 23990 LACTATE SCOUT+
Mesure rapide, précise et fiable du lactate

Mémorise + de 250 résultats

Utilisation facile:
- 0,5 µl seulement de sang capillaire nécessaire
- capteurs pré-calibrés; dispositif calibré par simple codage
- mesure du lactate, date/heure, modes, temp. et mémoire ID sur un seul écran

Rapide et précis:
- méthode de détection ampérométrique enzymatique
- résultats en 10 secondes
- plage de mesure: 0,5 - 25 mmol/L (±3%)

Mesure des performances:
- mesures simples et step-test (repos/exercice/récréation)
- pause et chronomètre avec compte à rebours

Technologie Bluetooth intégrée et logiciel pour PC:
Clé USB pour un transfert facile vers le PC où un logiciel en 4 langues (GB, DE, IT, ES) facilite la gestion des données.
Fourni avec un sac en nylon, 10 lancettes, 6 bandelettes, 1 solution-tampon, 2 piles AA 1,5, 1 clef USB, 1 manuel (GB), 1 manuel sur CD (GB, FR, IT, DE ,ES, DK, FI, NO, RU, SE, TR, CN), manuel rapide sur CD et boîte (BG, CZ, EE, GR, HR, HU, LT, LU, LV, PL, PT, RO, RS, SI)

• 23991 BANDELETTES - tube de 24

• 24513 LANCETTES AUTOMATIQUES ONE-STEP SAFETY - boîte de 100

CE 0123

FDA

Format de poche:
91 x 55 x 24 mm
Poids: 80 g

23990

Connectivité Bluetooth intégrée

Manipulation facile en 3 étapes



Retirer le capteur et l'insérer dans l'analyseur

Piquer le doigt et prélever le sang en touchant le capteur

Résultats visibles en 10 secondes

HEMO CONTROL: MESURE DE L'HÉMOGLOBINE ET DES HÉMATOCRITES

• 23994 HEMO CONTROL
Détection rapide, simple et précise de l'hémoglobine et des hématocrites du sang total:
- deux tests en un
- résultats rapides en 25-60 secondes
- quantité de sang limitée 8 ul
- écran tactile
- ne doit pas être calibré, autotest automatique
- mémoire: 4 000 résultats y compris date et heure
- contrôle des niveaux faible, normal et élevé de l'hémoglobine
- batterie rechargeable intégrée (100 heures)
- logiciel multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL)
- livré avec transformateur (pour recharger la batterie), cuvette de contrôle, kit de nettoyage, manuel en GB, manuel sur CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU)

• 23995 MICROCUVETTES HÉMOGLOBINE - boîte de 50

• 24513 LANCETTES AUTOMATIQUES ONE-STEP SAFETY - boîte de 100

Compact
160 x 160 x 68 mm
seulement
Poids 700 g

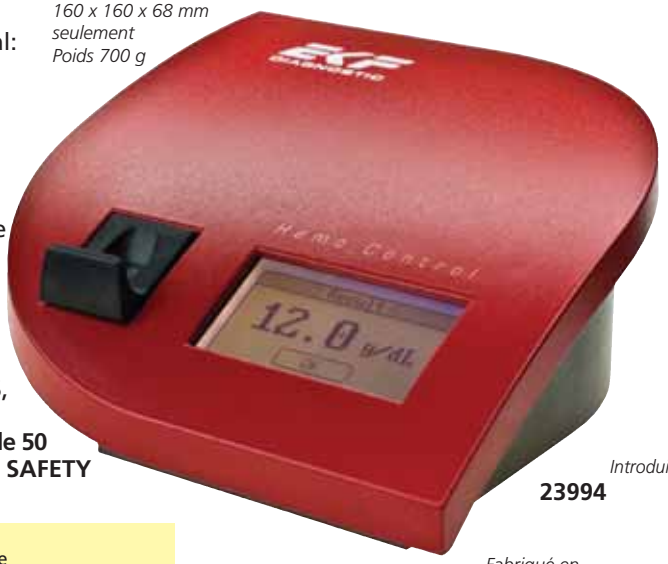

Grand écran LCD tactile et rétroéclairé

Fabriqué en Allemagne

23994

Manipulation facile en 3 étapes

Prélever 8 µl de sang

Introduire la microcuvette dans l'appareil

Résultats lisibles à l'écran en 25-60 sec

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode de mesure:	photométrique, azide-méthémoglobine
Plage de mesure:	0-25,6 g/dL (0-15,9 mmol/L)
Volume de l'échantillon:	8 µl
Échantillon:	sang veineux, artériel ou capillaire
Précision:	<2%
Linéarité:	0-20 g/dL ±0,3 g/dL >20 g/dL ±0,7 g/dL
Calibré selon les normes:	NCCLS
Alimentation:	110-250 V - 50/60 Hz; batterie intégrée (env. 100 heures)

CENTRIFUGEUSES POUR MICROHÉMATOCRITE

• 24025 CENTRIFUGEUSE MICROHÉMATOCRITE - 180 s
Système économique, d'emploi facile, totalement automatique avec affichage à LED, sans vibrations, silencieux, rapide et fourni avec batterie rechargeable. Utile pour: petits laboratoires, laboratoires de cabinet, centres de prises de sang, pédiatrie et néonatalogie, centres de dialyse, laboratoires de salle d'urgence, vétérinaires, prép. échantillons pour biochimie d'urgence.

CE

• 24026 CAPILLAIRES pour microhématocrite - tube de 500
En verre, 9 microlitres.
Longueur 32 mm Ø 1,5 mm



24026

24025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation:	Batterie rechargeable (chargeur de batterie fourni, 100 ÷ 240 V).
Dimensions:	136 mm (L) x 215 mm (l) x 122 mm (H)
Poids:	Approx 1,2 kg.